




Security

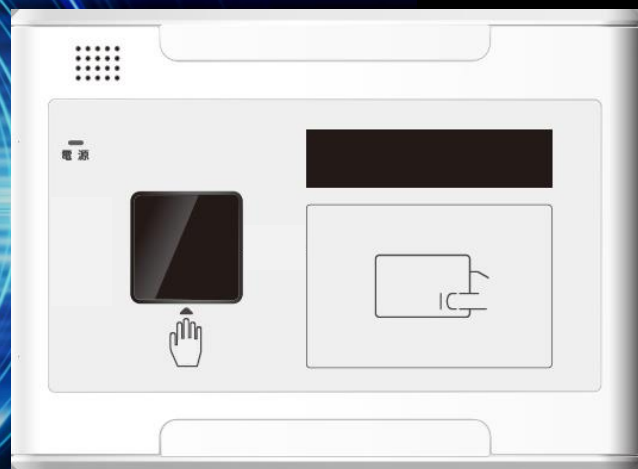

非接触で、認証可能。

スタンドアロンタイプの新しいセキュリティ機器



1

生体認証「手のひら静脈認証機器※1」と
カード認証の2要素認証が可能

2


スタンドアロン※2で運用可能な利便性

■ 製品の特長 ■

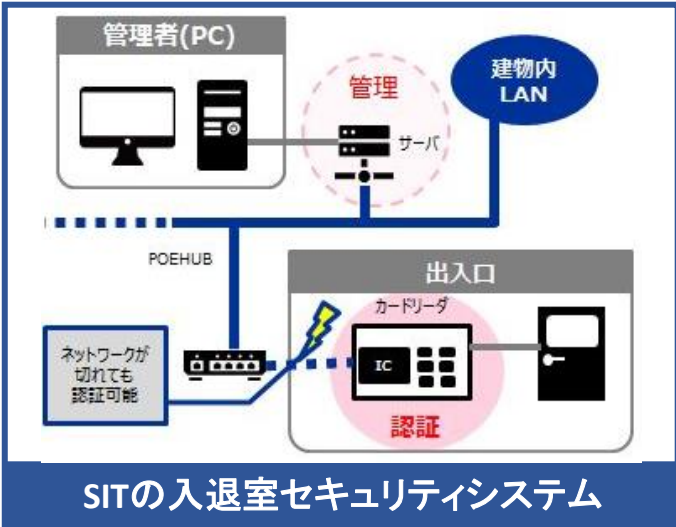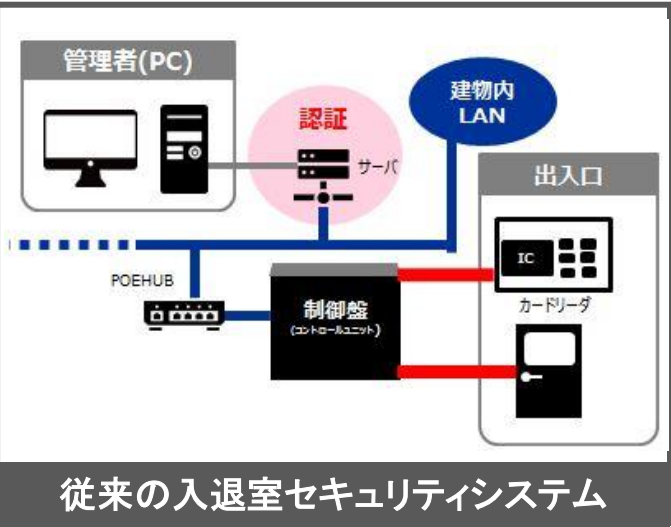

従来のサーバ型認証から、スタンドアロン型認証に変更。ネットワークが途切れても認証可能に。
本機器はネットワークが途切れる前までに登録した情報を基に認証を行い、履歴情報も一定期間保有可能です。

■ 入退室管理システムの流れ ■

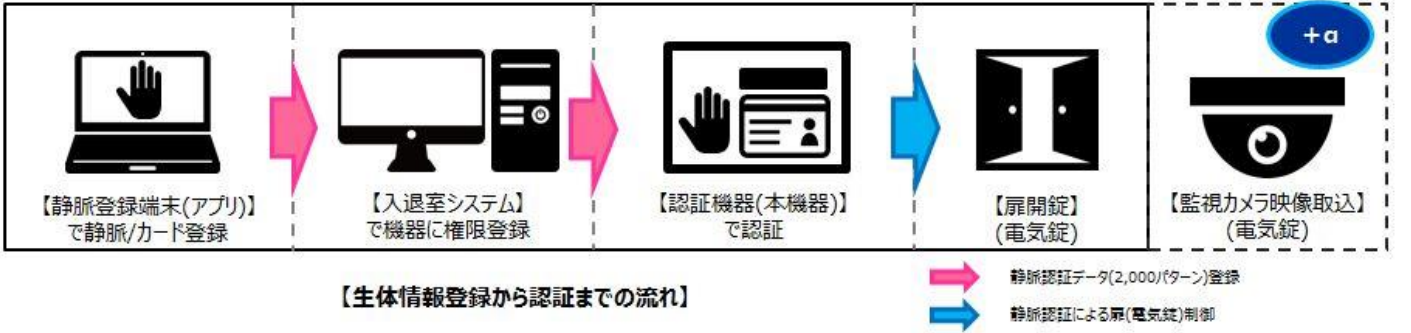

■ 仕様詳細 ■

項目	仕様
使用可能カード	Felica/Type-B(要相談)
電気錠制御方式	ソレノイド錠/モータ錠 単独対応
電源	PoE(IEEE 802.3 at準拠)
通信インターフェース	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Ethernet:IEEE802.3
通信方法	TCP/IP
使用環境	0℃～40℃ / 20%～80%PH
利用者情報登録数(静脈認証部分)	1,000ID
外寸	163(W) × 121(H) × 56(D)mm※(D)は埋め込み部分含む(非埋め込み部分:11mm)

！ 安全に関するご注意 ■ 本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

■ 本製品の日本国外での使用については一切のサポート、保証をしております。 ■ 本カタログの記載内容は2021年4月1日現在のものです。 ■ 仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■ 本体を動作させるには、別途「入退室管理システム」が必要になります。 ■ 本カタログに記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標あるいは商標です。

本製品のお問い合わせ先 **正興ITソリューション株式会社** ■ お電話によるお問い合わせ先 **☎(092)-473-2282**
■ FAXによるお問い合わせ先 **☎(092)-473-9065**

正興ITソリューション(株)の製品に関する詳細な情報はホームページをご覧ください > <https://www.seiko-itsolution.co.jp/>



※1…手のひら静脈認証機器は富士通フロンテック株社の製品です。
※2…ネットワーク接続が切れても機器単体で認証可能です。